



## INFORME COMISIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN N° 14/2015 PARA CONTRATO MARCO DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO PARA BOMBEROS.

### ANTECEDENTES GENERALES:

#### I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 14/2015 para contrato marco de desfibrilador automático externo para Bomberos.
- b) Respuestas a Consultas efectuadas por "Bomberos de Chile".

#### II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Marcelo Quijada Pino, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Ricardo Venegas Millar, Voluntario Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.
- Andrés Gantes Garrido, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.

También participo de la comisión don Alberto Sepúlveda Neira, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 8 de agosto de 2015 a las 10:00 horas en una primera instancia para el conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

#### III. PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA "EVALUACIÓN TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACION.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

1. Conocimiento del acta de apertura de fecha 2 de julio del 2015, y recepción de ofertas de las siguientes empresas, **ANDOVER, ARQUIMED, HEMISUR Y FEREXPO.**

2. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 14/2015 de fecha 7 de julio 2015, en el que se informa que la empresa cumple con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
3. Determinación de la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.
4. Conocimiento de las características detalladas en los manuales técnicos ofertados y su conformidad.
5. Asignación de puntaje técnico.

Nota: Esta comisión solicito aclaraciones de índole técnico a las siguientes empresas ARQUIMED y HEMISUR, las cuales fueron respondidas satisfactoriamente en el tiempo correspondiente.

Procediendo de la manera antes señalada, se dio cumplimiento al "Procedimiento de Evaluación" contemplado en las Bases Administrativas de la licitación, cláusula novena, en cuanto a la determinación por parte de la Comisión del "Ajuste de las ofertas a las bases técnicas", "Evaluación y Asignación Puntaje Técnico" y la confección del "Acta de la Comisión Técnica", procesos que en adelante se desarrollan:

#### **IV. AJUSTE DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS.**

##### **1. ANDOVER**

Se presenta con el equipo Marca PHILIPS, modelo HeatStar HS1, con las siguientes características:

- Descarga aplicada por el operador.
- Bolso de transporte.
- Parches adultos y pediátricos.

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje.

##### **2. ARQUIMED**

Se presenta con el equipo Marca cardiolife AED, modelo AED-2100K, con las siguientes características:

- Descarga aplicada por el operador.
- Bolso de transporte.
- Parches universales.

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje.

### 3. HEMISUR

Se presenta con el equipo Marca Primedic/Spacelabs, modelo HeartsSave PAD, con las siguientes características:

- Descarga aplicada por el operador.
- Parche universal.
- Aclaración exigible bolso de muestra.

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje.

### 4. FEREXPO

Se presenta con el equipo Marca POWERHEART, modelo G3 PLUS SEMI-AUTOMATICO9390E-1003, con las siguientes características:

- Descarga aplicada por el operador.
- Parches adultos y pediátricos.
- Bolso de transporte.


Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje.

### V. Asignación de puntaje

En la revisión realizada por esta comisión, se estableció que el oferente cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo cual se procede a asignar puntaje técnico.


TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE	
ANDOVER Marca PHILIPS, modelo HeatStar HS1	47,98 Puntos
ARQUIMED Marca cardiolife AED, modelo AED-2100K	46,95 Puntos
HEMISUR Marca Primedic/Spacelabs, modelo HeartsSave PAD	44,07 Puntos
FEREXPO Marca POWERHEART, modelo G3 PLUS SEMI-AUTOMATICO9390E-1003	49,54 Puntos

Es todo cuanto podemos informar. \

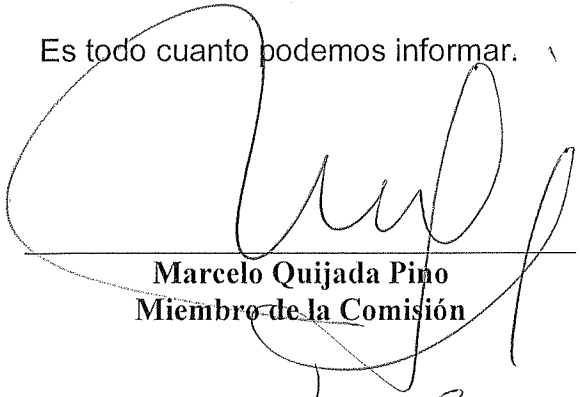


---

**Marcelo Quijada Pino**  
Miembro de la Comisión

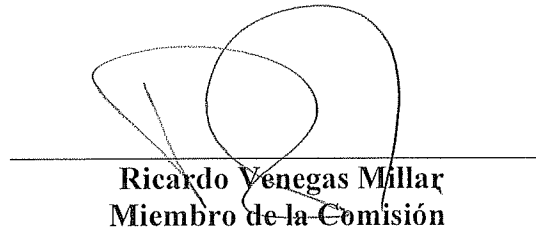

---

**Ricardo Venegas Millar**  
Miembro de la Comisión



---

**Andrés Gantes Garrido**  
Miembro de la Comisión



---

**Alberto Sepúlveda Neira**  
Encargado Técnico

Santiago, 13 de agosto 2015.

c.c. Carpeta Licitación.  
Depto. Técnico





Tabla de Puntajes Desfibriladores Automáticos Externos Contrato Marco 14/2015

	CONDICION	PUNTAJE
Incluir al menos 5 kit de parches de repuesto (5 adultos y 5 pediátricos o 5 parches univertales)	SI CUMPLE	15
Se realiza prueba de resistencia a caída e impactos. (Se deja caer de una altura de 1 metro a una superficie de concreto).*	PASA FALLA	10 PUNTOS ELIMINADO
Cantidad de descargas garantizadas por el fabricante a máxima capacidad	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5
Cantidad de descargas garantizadas, después del primer aviso de batería baja.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5
Temperatura máxima ambiental en que puede funcionar el DAE (en Grados Celsius)	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5
Temperatura mínima ambiental en que puede funcionar el DAE (en Grados Celsius)	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	5
Garantía: 2 años= 2 Puntos; 3 años o más= 5 puntos	SEGUN TABLA	5
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>

ANDOVER Marca PHILIPS, modelo HeartStar HSI	ARQUIMED Marca cardilife AED, modelo AED-2100K	HEMISUR Primedic/Spacelabs, modelo HeartSave PAD	FERREPO Marca POWERHEART, modelo G3 PLUS SEMI-AUTOMATICO399DE-1003
DATO	DATO	DATO	DATO
PUNTAJE	PUNTAJE	PUNTAJE	PUNTAJE
Kit de parches	Kit de parches	Kit de parches	Kit de parches
Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
200 descargas	140 descargas	140 descargas	290 descargas
9 descargas	9 descargas	3 descargas	9 descargas
50° C	50° C	55° c	50° C
0° C	0° C	0°c	0° C
3 años	3 años	3 años	7 años
<b>47,98</b>	<b>46,95</b>	<b>44,07</b>	<b>49,54</b>

